

## ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка  
за доставкана диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати, за  
нуждите на „СБАЛ по онкология” - ЕАД

Днес,.....2015 г., в гр. София, между:

„Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, със седалище в гр.София и адрес на управление район Студентски, п.к. 1756, ул.”Пловдивско поле” №6, ЕИК 000662776, представлявано от д-р Валентин Ангелов – Изпълнителен директор и Петрана Лалева – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от една страна,

и

„Марвена Диагностика” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1799, район Младост , ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян № 44, ЕИК 200600292, представлявано от НАДЯ ЕВСТАТИЕВА ДРАГОЕВА-управител, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ от друга страна,

на основание чл.183 и следващите от ЗЗД, чл.318 и следващите от ТЗ, във връзка с чл. 41 от Закона за обществени поръчки, в съответствие с решение № 222/20.07.2015 год год. на Изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящият договор за доставка при следните условия:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). Предмет на настоящия договор са периодични доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати, наричани в договора СТОКИ съобразно потребностите на КУПУВАЧА, по видове, прогнозни количества, единични цени и обща стойност, съгласно Спецификация – Приложение № 1 неразделна част от договора.

(2). Конкретните доставки в рамките на предмета на настоящия договор се извършват въз основа на писмени заявки на КУПУВАЧА, в зависимост от неговите фактически потребности и в съответствие със спецификацията и предложението за изпълнение на поръчката на ПРОДАВАЧА за съответните обособени позиции, за които е определен за Изпълнител на обществената поръчка по проведената открита процедура.

(3). Предложенията за изпълнение на поръчката на ПРОДАВАЧА са неразделна част от настоящия договор - Приложение № 2, като условията им се считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено.

### II. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1). Общата стойност на договора за периода на действието му възлиза на **25 663.68** (двадесет и пет хиляди шестотин шестдесет и три лева и 68 стотинки) лева без ДДС, и с включен ДДС – **30 796,41** лв., формирана, както следва:

- обща стойност за обособена позиция № 2 **Реактиви и консумативи за КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР SIEMENS-RL248 /оферта за цялата обособена позиция/,** в размер на **25 663.68** ( тридесет и шест хиляди сто и деветнадесет лева и 96 стотинки) лева, без ДДС; въз основа на офериранияте единичните цени и количествата в рамките на възложените с настоящия договор позиции и съгласно Спецификацията – Приложение № 1, неразделна част от договора.

(2). Единичните цените на стоките, предмет на настоящия договор са съгласно класираната оферта на ПРОДАВАЧА и включват всички разходи до мястото на изпълнение.

Чл.3. ПРОДАВАЧЪТ гарантира изпълнението на настоящия договор посочени съобразно посочените в офертата му, валидни за целия договорен срок.



1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

Чл.4. Изменение на договорените цени се допуска само на основанията предвидени вЗОП и приложимата относно обекта на поръчката нормативна база.

Чл.5. Плащанията на доставените стоки се извършват чрез банков превод по следните банкови сметки на ПРОДАВАЧА:

**IBAN: BG83BNPA94401020058210**

**Банка: BNP PARIBAS,София**

в срок – 60 (шестдесет) дни, след предаването на стоките и представяне на следните документи:

а/. Оригинална фактура, издадена от ПРОДАВАЧА, подписана и одобрена от упълномощен представител на КУПУВАЧА. Във фактурата се посочва номер и дата на договора;

б/. Приемателно - предавателен протокол;

в/. Сертификати, разрешения и инструкции за правилното им съхранение и ползване, подписан от ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА.

### III. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл.6. Доставките на стоките, предмет на настоящия договор се извършват от ПРОДАВАЧА въз основа на писмена заявка на КУПУВАЧА, в срок до 3 работни дни от получаване на заявката, а при спешна необходимост от доставка на малки количества в срок до 24 часа, от получаването ѝ. В писмената заявка на КУПУВАЧА се съдържат индивидуализиращите признаци на стоките по (подпозиции-където е приложимо) обособената позиции, вид, търговско наименование и количество. Писмената заявка може да бъде изпратена и по факс или e-mail.

Чл.7.(1). За място на изпълнението се счита болничната аптека/централния склад на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София, съгласно заявката на КУПУВАЧА.

(2). За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са приети от материално-отговорното лице на КУПУВАЧА с приемателно-предавателен протокол.

(3). Доставката на стоките се удостоверява с подписана от получателя фактура и с приемателно-предавателен протокол.

Чл.8. Собствеността върху стоките и рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху КУПУВАЧА в момента на фактическото им приемане на мястото на изпълнението, съгласно предавателно-приемателния протокол.

Чл.9.(1). Качеството на доставените стоки трябва да отговаря на качеството на представените каталози, брошури, проспекти, или писма, декларации или други официални документи от производителите на съответните продукти, техническите стандарти на производителя, нормативните изискванията и декларираното в техническото/те предложение/я на ПРОДАВАЧА.


(2). Остатъчният срок на годност на доставените стоки трябва да бъде не по-малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.


### IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките в договорения срок със собствен специализиран транспорт, в съответствие с нормативно установените изискванията и да ги предаде, придружени с документите по чл.5, т. а/; б/ и в/ от настоящия договор.

Чл.11. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде стоките от съответната подпозиция/обособена позиция, произход, количество и качество на мястото на доставяне и на материално-отговорното лице на КУПУВАЧА.

Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи необходимите документи за извършване на плащането най-късно в деня на доставяне на стоките.

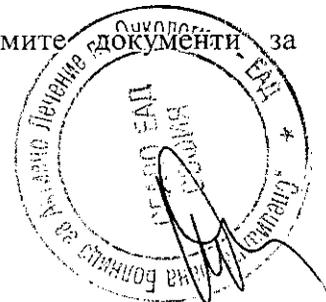



Чл.13.(1). ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи гаранция за изпълнение на настоящия договор, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, и със срок на валидност два месеца след изтичане срока на договора.

(2). Гаранцията за изпълнение на договора е в общ размер на **1283,18** ( хиляда двеста осемдесет и три лева и 18 стотинки) лева без ДДС.

(3). Гаранцията по ал. 2 може да бъде дадена и под формата на банкова гаранция, валидна за срока на договора, плюс два месеца след крайния срок на изпълнение на договора, представена на КУПУВАЧА при подписване на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа условие за безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на КУПУВАЧА.

(4). Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на вредите от неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА, без това да изключва търсенето на обезщетение над нейния размер при действително претърпени вреди.

(5). При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА - частично или изцяло, и във връзка с това на претърпени вреди от страна на КУПУВАЧА, то последният се удовлетворява до размера на вредите от предоставената гаранция.

(6). Гаранцията за изпълнение, за всяка обособена позиция, се освобождава поетапно, ежемесечно след представяне на необходимите документи, съобразно изпълнената част от предмета на договор за съответния месец.

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстрани за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия и/или отклонения на доставените стоки, констатирани и предявени по реда на настоящия договор.

#### **V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА**

Чл.15. КУПУВАЧЪТ се задължава да предаде на ПРОДАВАЧА писмена заявка (или да я изпрати по факс или e-mail, посочен от ПРОДАВАЧА) за доставка на стоките, съдържаща всички данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор.

Чл.16. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме доставените продукти, съответстващи по вид, количество и качество на договорените и заявени от негова страна пред ПРОДАВАЧА.

Чл.17. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати цената на доставените стоки при условията на настоящия договор. В случай на възникнали затруднения в плащанията по обективни причини КУПУВАЧЪТ следва незабавно да уведоми за това ПРОДАВАЧА. За количества доставени от ПРОДАВАЧА извън/без заявка, КУПУВАЧА няма задължение за плащане.


Чл.18. КУПУВАЧЪТ може да откаже плащането на фактура, която не е оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството или не съответства на доставените стоки, както и когато доставката не е придружена с необходимите сертификати за качество на стоките. За отказа се съставя протокол подписан от двете страни, с посочване на причините за отказа.

#### **VI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ**

Чл.19. ПРОДАВАЧЪТ гарантира годността на доставените стоки съобразно изискванията на действащото законодателство и настоящия договор.

Чл.20. КУПУВАЧЪТ чрез материално-отговорното лице може да откаже получаване на стоките или част от същите при установени липси, нарушена цялост на опаковките, липса на придружаващи сертификати за качество, несъответствия с предадената писмена заявка, по-малък остатъчен срок на годност от договорения, (доставените реактиви и консумативи за лабораторни апарати не отговарят по качество на представените каталози, брошури, проспекти, или писма, декларации или други официални документи от производителите на съответните продукти, техническите стандарти на производителя, нормативните изискванията и декларираното в техническото/те предложение/я на Продавача) и други несъответствия.

Чл.21. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за:

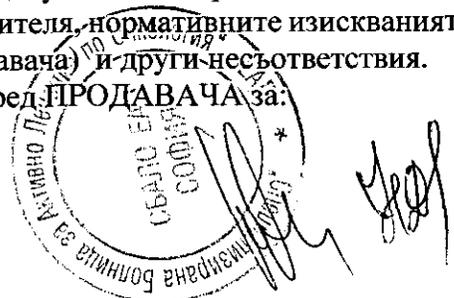

- явни недостатъци – в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки количества веднага при получаването;

- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки, въз основа на протокол, издаден от оторизиран държавен орган.

Чл.22. КУПУВАЧЪТ уведомява писмено включително по факс или e-mail ПРОДАВАЧА за наличието на дефекти в доставените стоки веднага след констатирането им. В рекламацията се посочва задължително писмената заявка, датата на доставката респ. протокола, вида на стоките, основанието за рекламацията и конкретното искане за отстраняване на дефектите.

Чл.23. При рекламация за явни несъответствия и/или отклонения ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в тридневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да замени/достави договорените стоки.

Чл.24. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в едноседмичен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск да замени стоките без необходимото качество с договорените или да върне получената цена за стоките, за които са направени рекламации, както и да заплати на КУПУВАЧА договорената неустойка.

## VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор включително забавено или неточно изпълнение, ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 10% върху стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.

Чл.26. Когато при наличие на рекламация ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по предходния раздел от настоящия договор или не ги изпълни в срок, същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 10% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

Чл.27. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧЪТ за доставка на заявените стоки включително откази, забавено или неточно изпълнение повече от три пъти за една и съща обособена позиция, КУПУВАЧЪТ има право да развали едностранно и без предизвестие този договор, както и да задържи предоставената от ПРОДАВАЧА гаранция.

Чл.28. КУПУВАЧЪТ има право да развали частично договора за отделни обособени позиции при условията посочени по-горе като в останалата част се запазва валидността на договора.

Чл.29. При неизпълнение на задълженията си за плащане на доставените стоки в уговорените срокове КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане.

Чл.30. КУПУВАЧЪТ удържа договорените неустойки от представената от ПРОДАВАЧА гаранция за добро изпълнение.

## VIII. СРОК НА ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.31. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие 12 /дванадесет/ месеца.

Чл.32. Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. С едностранно писмено уведомление, отправено от КУПУВАЧА при неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА, посочени в настоящия договор.

2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.

3. Поради виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, продължило повече от 15 дни – с едностранно писмено предизвестие от изправната страна.

4. В случай, че въз основа на влязъл в сила административен акт на ПРОДАВАЧА му бъде отнето правото да извършва договорената дейност.



5. При прекратяване на юридическото лице или откриване на производство по ликвидация на ПРОДАВАЧА.

6. В други законоустановени случаи.

Чл.33. В случай на виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на ПРОДАВАЧА по настоящия Договор, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати Договора с едностранно писмено уведомление без предизвестие. В този случай КУПУВАЧЪТ има правото да получи уговорената в раздел VII неустойка.

Чл.34. При настъпване на някои от обстоятелствата по т.4 и т.5 от член 32, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен незабавно да уведоми КУПУВАЧЪТ.

Чл.35. Изплащането на неустойки и обезщетения не лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

### IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.36. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА.

За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по факс или e-mail.

Адресите и координатите на страните са, както следва:

За КУПУВАЧА

Адрес за кореспонденция гр.София п.к. 1756 ул. "Пловдивско поле" № 6 факс 8706321

За ПРОДАВАЧА

Адрес за кореспонденция София 1799, район Младост , ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян  
No 44

Чл.37. Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати , без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки или други такива.

Чл.38. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и изпълнение на задълженията си по настоящия договор :

За КУПУВАЧА

Гинка Илчева – Управител „Централен склад”, тел. 02/807 62 40

М.ф. Калина Станева – Управител „Болнична аптека”, тел. 02/807 62 91

За ПРОДАВАЧА

Мануела Цветкова – тел. 0882415055 manuela.cvetkova@marvena-dx.com,  
тел.02/9748660,факс:02/9748655

Чл.39. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл.40. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението или прекратяването му, ще се уреждат от страните по споразумение.

Чл.41. При непостигане на споразумение страните се договарят да отнесат спора за разглеждане и решаване от компетентния съд.

Чл.42. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.



A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.

Чл.43.(1).При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител – правоприемник.

(2). При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по предходната алинея, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия искиков ред.

Чл.44. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:

- Документи по чл.47 от ЗОП.
- Гаранции за изпълнение на договора.

Неразделна част от настоящия договор са Спецификация – Приложение № 1 и предложенията за изпълнение на поръчката, за всяка обособена позиция, по настоящия договор - Приложение №2, офертата на изпълнителя и приложенията към нея.

Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра – два да купувача и един за продавача.

За КУПУВАЧ:  
Изпълнителен директор:  
(д-р Валентин Ангелов)

Главен счетоводител:  
(Петрана Лалева)

*[Signature]*  
20-08-15

За ПРОДАВАЧ:

*[Signature]*



Съгласували:

Красимир Витанов – ръководител отдел „ПОП”

Розка Гоцева- финансов контролър

Изготвил:


Цветолюба Васева – юристконсулт

*[Signature]*  
19.08.2015г.

**Образец К  
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА  
ЗА ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ**

| Общо<br>бене<br>позици<br>я № 2 | Наименование  | Разфас<br>овка | Мери<br>а.ед. | Прото<br>зид<br>годиш<br>о | Търговско<br>наименован<br>ие | Предлагана<br>Фабрична<br>Опаковка | Брой опаки<br>годишно | Производител и<br>Kаталожен №                             | Отрицател<br>я | Слична<br>цена за<br>слична<br>марка без<br>ДДС | Слична<br>цена за<br>опаковка<br>без ДДС | обща<br>стойност<br>без ДДС-<br>изчислена<br>до втори<br>десетици<br>знак |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|----------------|---|--|---|
|                                 |               |                |               |                            |                               |                                    |                       |   |                |   |  |   |
| 2.1.                            | PCO2-електрод | бр.            | бр.           | 2                          | PCO2<br>ЕЛЕКТРОД RL<br>248    | Предлагана<br>Фабрична<br>Опаковка | 2                     | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2671199 | да             | 1140.9  | 1140.9                                   | 2281.80   |
| 2.2.                            | pH електрод   | бр.            | бр.           | 2                          | pH ЕЛЕКТРОД<br>RL 248         |                                    | 2                     | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>7173251 | да             | 831.6   | 831.6                                    | 1663.20   |
| 2.3.                            | pO2 електрод  | бр.            | бр.           | 2                          | pO2<br>ЕЛЕКТРОД RL<br>248     |                                    | 2                     | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>6462640 | да             | 1140.9  | 1140.9                                   | 2281.80   |
| 2.4.                            | Буфери        | л              | оп.           | 10                         | БУФЕРИ<br>6.8/7.3<br>RL 248   | 4x90 мл./<br>4x370 мл.             | 10                    | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>3788731 | да             | 383.35  | 383.35                                   | 3833.50   |

\* МАРБЕНА  
 ДИАГНОСТИК  
 ООЛ




|       |                               |                            |     |    |                                      |                                      |          |    |   |    |        |        |         |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----|----|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----|---|----|--------|--------|---------|
| 2.5.  | Бъркалки за капилярки         | 500бр.                     | оп. | 2  | 500 бр.                              | БЪРКАЛКИ ЗА КАПИЛЯРКИ                | 500 бр.  | 2  | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 8004    | Да | 52.95  | 52.95  | 105.90  |
| 2.6.  | Депротенизиращ разтвор        | 10x2мл                     | оп. | 10 | 10x2 мл.                             | Депротенизиращ разтвор RL 248        | 10x2 мл. | 10 | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 8915030 | Да | 62.59  | 62.59  | 625.90  |
| 2.7.  | Калибриращ газ                | бр.                        | бр. | 2  | А477434                              | Калибриращ газ RL 248                | 1 бр.    | 2  | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 1081150 | Да | 831.67 | 831.67 | 1663.34 |
| 2.8.  | Капачки за капилярки          | 500БР. 2,0-2,4mm           | оп. | 1  | 500БР 2-2.4                          | КАПАЧКИ ЗА КАПИЛЯРКИ                 | 500 бр.  | 1  | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 8005    | Да | 69.68  | 69.68  | 69.68   |
| 2.9.  | Капилярки                     | 100бр. ЛИТ.ХЕ ПАРИН 140mkl | оп. | 1  | КАПИЛЯРКИ 100бр. ЛИТ.ХЕПАРИН 140mkl  | КАПИЛЯРКИ                            | 100 бр.  | 1  | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 4526    | Да | 22.3   | 22.3   | 22.30   |
| 2.10. | Касета за референтен електрод | бр.                        | бр. | 2  | КАСЕТА ЗА РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД RL 248 | КАСЕТА ЗА РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД RL 248 | 1 бр.    | 2  | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 4273425 | Да | 814.93 | 814.93 | 1629.86 |
| 2.11. | Кондициониращ разтвор         | 5x2мл                      | оп. | 10 | 5x2мл                                | КОНДИЦИОН ИРАЩ РАЗТВОР RL 248        | 5x2 мл.  | 10 | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 2578644 | Да | 67.37  | 67.37  | 673.70  |

ООО  
\* МАРСЕНА \*  
ДИАГНОСТИКА




|       |                                       |                  |     |    |    |  |                    |    |   |        |        |         |
|-------|---------------------------------------|------------------|-----|----|----|--|--------------------|----|---|--------|--------|---------|
| 2.12. | Контрол Rapid QC ниво 1               | 30амп.х<br>2.5мл | оп. | 1  | 1  | Контрол<br>Rapid QC ниво<br>1                            | 30 амп.х2.5<br>мл. | 1  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>1 2017464 | 371.45 | 371.45 | 371.45  |
| 2.13. | Контрол Rapid QC ниво 2               | 30амп.х<br>2.5мл | оп. | 1  | 2  | Контрол<br>Rapid QC ниво<br>2                            | 30 амп.х2.5<br>мл. | 1  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>1 7519905 | 371.45 | 371.45 | 371.45  |
| 2.14. | Контрол Rapid QC ниво 3               | 30амп.х<br>2.5мл | оп. | 1  | 3  | Контрол<br>Rapid QC ниво<br>3                            | 30 амп.х2.5<br>мл. | 1  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>1 7182730 | 371.45 | 371.45 | 371.45  |
| 2.15. | Миеш и кондициониращ пакет            | 4х450м<br>л      | оп. | 10 | 10 | Миеш и<br>кондиционир<br>ащ пакет<br>RL 248              | 4х450 мл.          | 10 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2436114   | 143.17 | 143.17 | 1431.70 |
| 2.16. | Пълнеж разтвор за референтен електрод | 4х5мл            | оп. | 10 | 10 | Пълнеж<br>разтвор за<br>референтен<br>електрод RL<br>248 | 4х5 мл.            | 10 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2563698   | 55.25  | 55.25  | 552.50  |
| 2.17. | Пълнеж разтвор за рН електрод         | 3х3мл            | оп. | 10 | 10 | Пълнеж<br>разтвор за рН<br>електрод RL<br>248            | 3х3 мл.            | 10 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>6386650   | 55.25  | 55.25  | 552.50  |
| 2.18. | Референтен електрод                   | бр.              | бр. | 2  | 2  | РЕФЕРЕНТЕН<br>ЕЛЕКТРОД RL<br>248                         | 1 бр.              | 2  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>9388182   | 393.14 | 393.14 | 786.28  |

ООО  
\* МАРБЕН  
ДИАГНОСТИКА



|       |                                   |                    |     |    |   |       |    |  |            |    |        |        |         |
|-------|-----------------------------------|--------------------|-----|----|---|-------|----|--|------------|----|--------|--------|---------|
| 2.19. | Референтен електрод с касета      | бр.                | бр. | 1  | РЕФЕРЕНТЕН<br>ЕЛЕКТРОД С<br>КАСЕТА RL<br>248      | 1 бр. | 1  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH / | 15719400   | да | 700    | 700    | 700.00  |
| 2.20. | Слоуп газ                         | бр.                | бр. | 2  | Слоуп газ RL<br>248 A477438                       | 1 бр. | 2  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH / | 2124945    | да | 831.67 | 831.67 | 1663.34 |
| 2.21. | Терморолка                        | бр.                | бр. | 30 | ТЕРМОРОЛКА  | 1 бр. | 30 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH / | 1585140045 | да | 4.17   | 4.17   | 125.10  |
| 2.22. | КИТ Шлаухи за шише                | бр.                | бр. | 2  | КИТ Шлаухи<br>за шише                             | 1 бр. | 2  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH / | 2660073    | да | 189.2  | 189.2  | 378.40  |
| 2.23. | Мандрен за почистване на съсиреци | бр.                | бр. | 5  | МАНДРЕН ЗА<br>ПОЧИСТВАНЕ<br>НА СЪСИРЕЦИ<br>RL 248 | 1 бр. | 5  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH / | 7110136    | да | 22     | 22     | 110.00  |
| 2.24. | KIT O-RING                        | 200/800<br>S ELCTD | бр. | 2  | KIT O-RING<br>200/800S<br>ELCTD                   | 1 бр. | 2  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH / | 6692603    | да | 31.4   | 31.4   | 62.80   |
| 2.25. | Държач за входна игла             | бр.                | бр. | 3  | ДЪРЖАЧ ЗА<br>ВХОДНА ИГЛА<br>RV 248                | 1 бр. | 3  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH / | 6152072    | да | 355    | 355    | 1265.00 |

355 0 A065.00  
\* МАРБЕН -  
ДИАГНОСТИКА



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от “Марвена Диагностика ООД” - София,  
представявано от Силвия Ангелова Кирова – търговски мениджър  
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  
“Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати”,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,**

Прилагам попълнена „Техническа спецификация на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати”, неразделна част от настоящото предложение за изпълнение на поръчката, включващо номера на обособената позиция, респ. подпозициите за която участваме, наименование на продукта, единична мярка, прогнозно годишно количество, търговско наименование, предлагана фабрична опаковка, брой опаковки годишно, производител и каталожен номер, и оторизация.

Доставките ще извършваме при следните условия:

1. Предлагам диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати с доказан произход, подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящото предложение за изпълнение на поръчката, съответстващи на нормативно установените изисквания.

2. Декларирам, че:

- всички предлагани от нас продукти отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия, както и на други приложени към предмета на поръчката нормативни актове, БДС и действащите международни стандарти, като се задължаваме при възлагане на обществената поръчка и при извършване на доставки да представяме всички нормативно установени документи;

- всички предлагани от нас стоки ще бъдат доставяни в опаковка, която е непохабена, разкъсана, зацапана или с всякакви други видими белези, които не позволяват разчитане на данните и информацията върху същите;

- в случай, че предлаганите от нас продукти са определени от производителите /съгласно представените в плик №1 документи/, като медицинските изделия, и са внесени от трети държави на територията на Европейския съюз или на територията на Европейското икономическо пространство, върху опаковките и в инструкцията за употреба ще бъде посочено допълнително името и адресът на упълномощения представител и на вносителя, съгл. чл.16, ал.2 от Закона за медицинските изделия;

- в случай, че бъдем определени за изпълнители и сключим договор за доставка, ще осигурим, и ще поддържаме складова наличност от оферирания продукт от обособената позиция/подпозиция, в размер на 1/12 част от общото договорено годишно количество;


- в случай, че бъдем определени за изпълнители се задължаваме да доставим продукти, съответстващи на представените каталог, брошури, проспекти, или писма, декларации или други официални документи от производителите на съответните продукти.

- срокът на годност на доставяните продукти към датите на всяка една доставка ще бъде не по-малък от 75 % /седемдесет и пет процента/.

- в случай, че представляваният от мен участник, бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще бъдат осигурени необходимите количества за извършване на доставките за целия период на договора, точно и в срок;

- в случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, ще изпълняваме задълженията си през целия договорен срок.

ООО  
★ МАРВЕНА ★  
ДИАГНОСТИКА



Приложение към Образец Й

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ЗА ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА**

| Реактиви и консумативи за КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР SIEMENS |               |                               |           |          |                             |                        |                    |   |            |
|---|---------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|------------|
| Обособяване на позиция №2                                 | Наименование  | Разфасовка                    | Мерна ед. | Протокол | Търговско наименование      | Пакетна форма          | Брон опак./Годишно | Производител и Каталоген №                    | Оторизация |
| 2.1.  | PCO2 електрод | бр.                           | бр.       | 2        | PCO2 ЕЛЕКТРОД RL 248        | 1 бр.                  | 2                  | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 2671199 | да         |
| 2.2.  | pH електрод   | бр.                           | бр.       | 2        | pH ЕЛЕКТРОД RL 248          | 1 бр.                  | 2                  | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 7173251 | да         |
| 2.3.  | pO2 електрод  | бр.                           | бр.       | 2        | pO2 ЕЛЕКТРОД RL 248         | 1 бр.                  | 2                  | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 6462640 | да         |
| 2.4.  | Буфери        | 6.8/7.3<br>4x90мл/4x<br>370мл | оп.       | 10       | БУФЕРИ<br>6.8/7.3<br>RL 248 | 4x90 мл./<br>4x370 мл. | 10                 | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH / 3788731 | да         |

\* МАРЕНА  
АНАГНОСТИК



|       |                               |                              |     |    |  |          |  |  |    |
|-------|-------------------------------|------------------------------|-----|----|--|----------|--|--|----|
| 2.5.  | Бъркалки за капилярки         | 500бр.                       | оп. | 2  | БЪРКАЛКИ ЗА КАПИЛЯРКИ<br>500 бр.             | 500 бр.  |  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2 8004     | да |
| 2.6.  | Депротенизиращ разтвор        | 10x2мл                       | оп. | 10 | Депротенизиращ разтвор<br>RL 248             | 10x2 мл. |  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>10 8915030 | да |
| 2.7.  | Калибриращ газ                | бр.                          | бр. | 2  | Калибриращ газ<br>RL 248<br>A477434          | 1 бр.    |  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2 1081150  | да |
| 2.8.  | Капачки за капилярки          | 500бр. 2,0-2,4mm             | оп. | 1  | КАПАЧКИ ЗА КАПИЛЯРКИ<br>500БР 2-2.4          | 500 бр.  |  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>1 8005     | да |
| 2.9.  | Капилярки                     | 100бр. ЛИТ.ХЕПАРИН ИН 140mkl | оп. | 1  | КАПИЛЯРКИ<br>100бр.<br>ЛИТ.ХЕПАРИН<br>140mkl | 100 бр.  |  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>1 4526     | да |
| 2.10. | Касета за референтен електрод | бр.                          | бр. | 2  | КАСЕТА ЗА РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД<br>RL 248      | 1 бр.    |  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2 4273425  | да |
| 2.11. | Кондициониращ разтвор         | 5x2мл                        | оп. | 10 | КОНДИЦИОНИРАЩ РАЗТВОР<br>RL 248              | 5x2 мл.  |  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>10 2578644 | да |

МАРЕЕВ  
ДИАГНОСТИКА

*[Handwritten signature]*




|       |                                       |                  |     |    |  |                    |    |   |    |
|-------|---------------------------------------|------------------|-----|----|--|--------------------|----|---|----|
| 2.12. | Контрол Rapid QC ниво 1               | 30амп.х2.5<br>мл | оп. | 1  | Контрол Rapid<br>QC ниво 1                               | 30 амп.х2.5<br>мл. | 1  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2017464 | Да |
| 2.13. | Контрол Rapid QC ниво 2               | 30амп.х2.5<br>мл | оп. | 1  | Контрол Rapid<br>QC ниво 2                               | 30 амп.х2.5<br>мл. | 1  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>7519905 | Да |
| 2.14. | Контрол Rapid QC ниво 3               | 30амп.х2.5<br>мл | оп. | 1  | Контрол Rapid<br>QC ниво 3                               | 30 амп.х2.5<br>мл. | 1  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>7182730 | Да |
| 2.15. | Миещ и кондициониращ пакет            | 4х450мл          | оп. | 10 | Миещ и<br>кондиционира<br>щ пакет RL<br>248              | 4х450 мл.          | 10 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2436114 | Да |
| 2.16. | Пълнеж разтвор за референтен електрод | 4х5мл            | оп. | 10 | Пълнеж<br>разтвор за<br>референтен<br>електрод RL<br>248 | 4х5 мл.            | 10 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2563698 | Да |
| 2.17. | Пълнеж разтвор за рН електрод         | 3х3ml            | оп. | 10 | Пълнеж<br>разтвор за рН<br>електрод RL<br>248            | 3х3 мл.            | 10 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>6386650 | Да |
| 2.18. | Референтен електрод                   | бр.              | бр. | 2  | РЕФЕРЕНТЕН<br>ЕЛЕКТРОД RL<br>248                         | 1 бр.              | 2  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>9388182 | Да |

ООО  
МАГЕН  
ДИАГНОСТИКА

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





|       |               |
|-------|---------------|
| 2.25. | Държач за в   |
| 2.26. | Кит игла \$ ш |
| 2.27. | Кит пред-наг  |
| 2.28. | Кит шлаухи з  |
| 2.29. | Подложка за   |

Дата: 09.06.20

|       |                                   |                   |     |    |   |       |    |  |    |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-----|----|---|-------|----|--|----|
| 2.19. | Референтен електрод с касета      | бр.               | бр. | 1  | РЕФЕРЕНТЕН<br>ЕЛЕКТРОД С<br>КАСЕТА RL<br>248      | 1 бр. | 1  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>5719400    | Да |
| 2.20. | Слоуп газ                         | бр.               | бр. | 2  | Слоуп газ RL<br>248 A477438                       | 1 бр. | 2  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2124945    | Да |
| 2.21. | Терморолка                        | бр.               | бр. | 30 | ТЕРМОРОЛКА  | 1 бр. | 30 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>1585140045 | Да |
| 2.22. | Кит Шлаухи за шише                | бр.               | бр. | 2  | КИТ Шлаухи за<br>шише                             | 1 бр. | 2  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>2660073    | Да |
| 2.23. | Мандрен за почистване на съсиреци | бр.               | бр. | 5  | МАНДРЕН ЗА<br>ПОЧИСТВАНЕ<br>НА СЪСИРЕЦИ<br>RL 248 | 1 бр. | 5  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>7110136    | Да |
| 2.24. | Кит O-RING                        | 200/800S<br>ELCTD | бр. | 2  | КИТ O-RING<br>200/800S<br>ELCTD                   | 1 бр. | 2  | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>6692603    | Да |

*[Handwritten signature]*

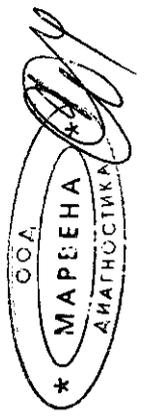




|       |  |     |     |   |   |       |   |   |    |
|-------|--|-----|-----|---|---|-------|---|---|----|
| 2.25. | Държач за входна игла                  | бр. | бр. | 3 | ДЪРЖАЧ ЗА<br>ВХОДНА ИГЛА<br>RL 248                        | 1 бр. | 3 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>6152072 | Да |
| 2.26. | Кит игла \$ шлаух                      | бр. | бр. | 3 | КИТ ИГЛА \$<br>ШЛАУХ RL<br>248                            | 1 бр. | 3 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>5738022 | Да |
| 2.27. | Кит пред-нагревател                    | бр. | бр. | 2 | КИТ ПРЕД-<br>НАГРЕВАТЕЛ<br>RL 248                         | 1 бр. | 2 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>8721783 | Да |
| 2.28. | Кит шлаухи за помпа на проба и реактив | бр. | бр. | 3 | КИТ ШЛАУХИ<br>ЗА ПОМПА НА<br>ПРОБА И<br>РЕАКТИВ RL<br>248 | 1 бр. | 3 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>9799603 | Да |
| 2.29. | Подложка за капки                      | бр. | бр. | 2 | ПОДЛОЖКА ЗА<br>КАПКИ RL<br>248                            | 1 бр. | 2 | Siemens<br>Healthcare<br>Diagnostics<br>GmbH /<br>3521867 | Да |


Дата: 09.06.2015

Подпис:

Силвия Кирова, търговски мениджър



*[Handwritten signature]*

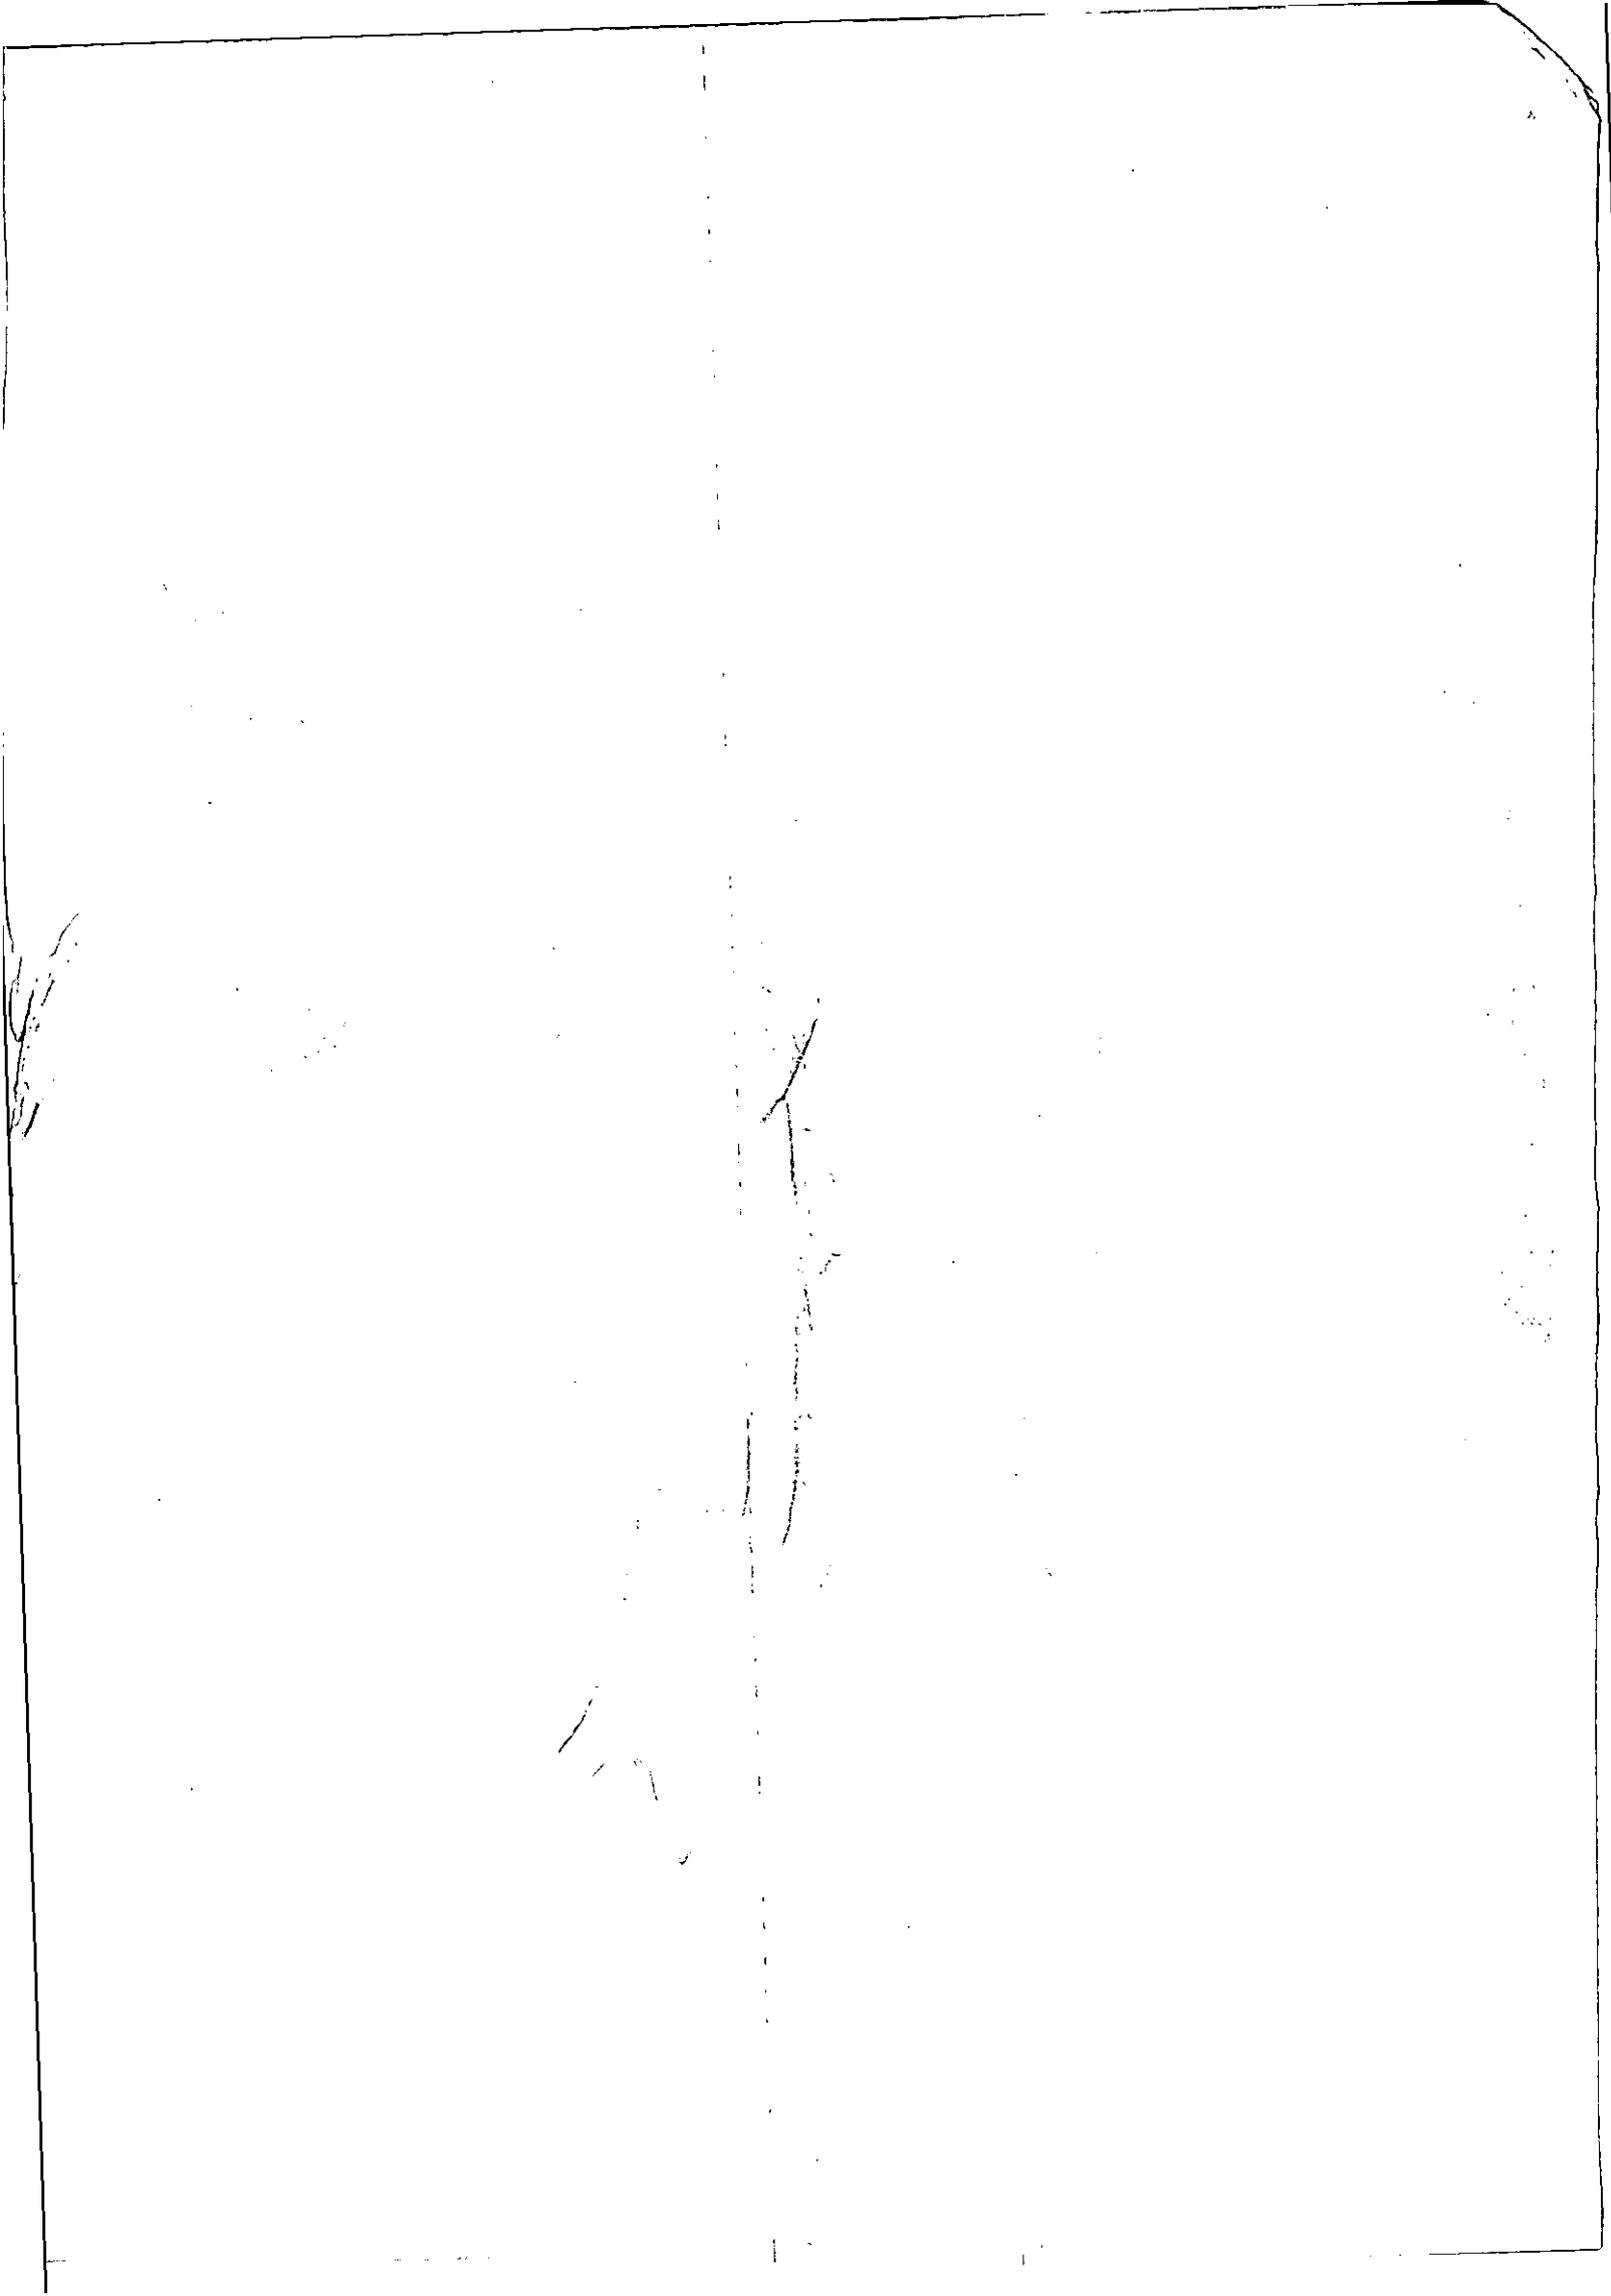

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл.33, ал.4 от ЗОП

Долуподписаната Силвия Ангелова Кирова, ЕГН 5510176709, ЛК № 640595320, издадена на 08.07.2010 г. от МВР-София, търговски мениджър в „Марвена Диагностика“ ООД, ЕИК 200600292 във връзка с участието ни в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати“ за нуждите на СБАЛ по онкология – ЕАД.

**ДЕКЛАРИРАМ,**

че информацията относно

- CE-Декларация за съответствие издадена от Siemens Healthcare Diagnostics Inc. – заверено от участника копие с превод на български език.
- Сертификат по ISO 9001:2008 на Siemens Healthcare Diagnostics Global Logistics – заверено от участника копие с превод на български език.
- Сертификат по ISO 13485:2003 на Siemens Healthcare Diagnostics Inc.– заверено от участника копие с превод на български език.
- Сертификати по ISO на “Марвена Диагностика” ООД – 2 броя, заверени от участника копия.
- Декларация за оригиналност на реактивите от производителя – оригинал.
- Оторизационно писмо от фирмата производител за доставка и сервиз на апаратурата и оборудването, за РБългария със срок на валидност до края на гаранционния срок – нотариално заверено копие с превод на български език.
- Декларация за приемане на условията в проекта на договора - оригинал.

в представеното предложение за изпълнение на настоящата поръчка представлява техническа или търговска тайна на участника, поради което не следва да бъдат предоставяни под каквато и да е форма на трети лица.

Съгласно чл. 33, ал. 5 от ЗОП възложителят няма право да разкрива информацията, предоставена му от участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП.

Дата: 09.06.2015 г.

Подпис:

Силвия Кирова,

Търговски мениджър



